



## モバイル版マニュアル

### 【PDA 用】

- ・インストール手順
- ・利用ガイド



EBSCO Publishing JAPAN

DynaMed は、**臨床現場**での利用を目的に医師により開発された「医師による、医師のための」**臨床サポートツール**であり、臨床上の疑問をより短い時間で解決できる「**EBM（科学的根拠に基づく医療）**」実践ツールです。系統的に構成された約**3,000**ものトピックを収録しており、PDA（Palm、Windows Mobile 共に）や iPhone/iPod Touch 等のモバイル機器でもご利用頂けます。

このマニュアルでは、DynaMed をモバイル機器にインストールし、実際にご利用される際の手順についてご案内いたします。

このマニュアルは PDA をご利用の方用です。

iPhone/iPod Touch をご利用の方は DynaMed モバイル版マニュアル【iPhone/iPod Touch 用】をご覧ください。

## 目次

1. DynaMed のモバイル機器でのご利用について  
p.3
2. DynaMed モバイル版対応機器  
p.3
3. DynaMed モバイル版 インストール準備  
p.3
4. DynaMed モバイル版をインストールする  
p.4
5. DynaMed の更新ファイルを手動でダウンロードする（PDA 版）  
p.10
6. DynaMed を PDA で使う  
p.14
7. お問い合わせ先  
p.16

# 1. DynaMedのモバイル機器でのご利用について

DynaMed は iPhone / iPod Touch, PDA (Palm、Windows Mobile 共に) でもご利用頂けます。

DynaMed モバイル版のデータは WEB 版と同じものになります。

DynaMed モバイル版のデータ更新頻度は毎週です。

DynaMed モバイル版に必要な携帯端末空き容量は **64MB** (2009 年 9 月現在) です。

DynaMed モバイル版のインストールには **シリアルナンバーが必要です**。

DynaMed モバイル版はパソコン版をご契約の方への無料サービスです。モバイル版のトライアルはご利用できませんのでご了承ください。

## 2. DynaMedモバイル版対応機器

- **Palm** - Palm OS 3.5 搭載機器  
(例) Palm m500 シリーズ、Palm m700 シリーズ、Treo シリーズ、Tungsten シリーズ、Zire シリーズ
- **Pocket PC** - Microsoft Windows Mobile 5.0、Microsoft PocketPC 2000 (ARM/X-SCALE のみ)、PocketPC 2002、PocketPC 2003、PocketPC 2003 SE. 搭載機器、Intel StrongArm、X-Scale、もしくは Samsung processor 搭載機器
- **Windows Smartphone**
- **Blackberry** - Blackberry OS 4.1 以上搭載機器
- **iPhone、iPod Touch**

## 3. DynaMedモバイル版インストール準備

**DynaMed モバイル版インストールの前にシリアルナンバーを取得する必要があります(無料)**

シリアルナンバーは DynaMed 日本語サポートページ(<http://www.ebsco.co.jp/medical/dynamed/>)の **専用お問い合わせフォーム**より申請してください。

その際、お問い合わせ内容の項目は「PDA シリアルナンバーの発行について」を指定し、所属機関名をご記入ください。数日中にメールにてシリアルナンバーをご連絡いたします。

お問い合わせフォームが利用できない場合はメール([medical@ebsco.co.jp](mailto:medical@ebsco.co.jp))で申請してください。

シリアルナンバーは、Web 版をご購入いただいている方(個人・機関)を対象に無料で発行しております。購読が確認できない場合、個別に連絡させていただくこともございます。

## 4. DynaMedモバイル版をPDAにインストールする

iPhone/iPod Touch 以外の端末をご利用の場合はこちらをご覧ください。

iPhone/iPod Touch をご利用の方は【5. DynaMed を iPhone/iPod Touch にインストールする】をご覧ください。


お客様の携帯端末に DynaMed をインストールするには、携帯端末本体に **64MB 以上**の空き容量が必要です(2009年11月現在)。予めお使いの機器の空き容量をご確認の上、作業を行ってください。

【1】PDA をインターネットに接続されているパソコンに接続します。

【2】PDA 向けソフトウェアのダウンロード

ご利用の携帯端末の種類に合わせて、パソコンにインストール用ファイルをダウンロードします。下記の、“Windows install for Palm”または“Windows install for Microsoft/Pocket PC”のいずれかが該当する URL よりダウンロードできます。


ファイルをダウンロード後、「Save」を選択してください。

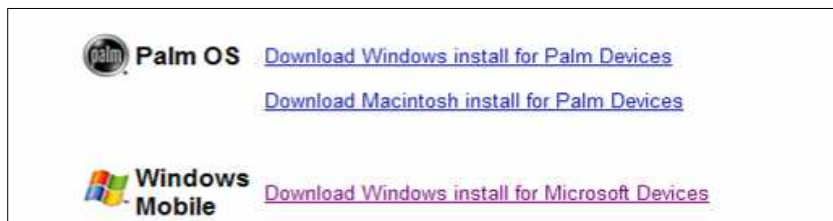

Mac をご利用の場合には Macintosh install for Palm をダウンロードし、その後「Save」を選択してください。

【3】Skyscape への登録

【2】でダウンロードしたファイルを実行すると、Skyscape のダウンロードが開始されます。[Next]をクリックし、先に進んでください。

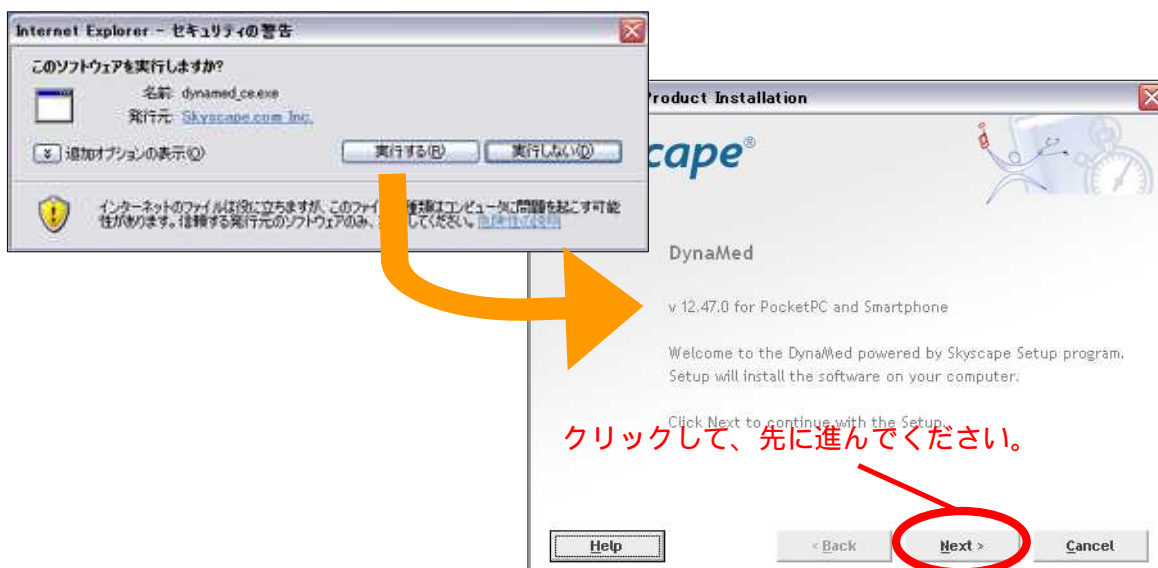




利用規約を確認の上、“ I agree to the terms of this license agreement ”  
(利用規約に同意する) を選択し、  
[Next]をクリックして下さい。



ダウンロードの形式を選択します。  
特に希望がない場合は、  
Express( Recommended )のまま、Next  
をクリックして下さい。

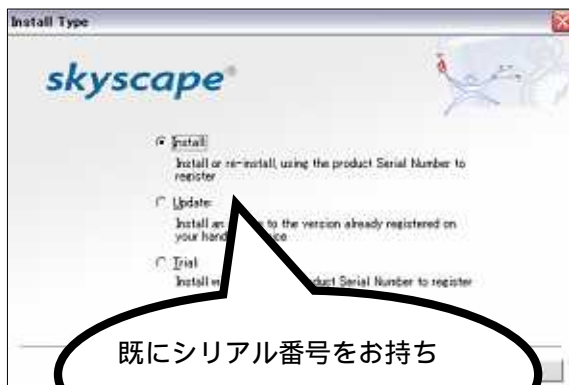


インストールタイプを  
選択します。ここでは、  
[Install]を選択し、「次へ」を  
クリックして下さい。



[New Customer]を選択し、ボックスに  
任意のプロファイル名を入力したら  
「次へ」をク





Skyscape のログイン画面へ移行します。  
既に Skyscape のアカウントをお持ちの方は、登録した E-mail アドレスとパスワードを入力し、次へをクリックして下さい

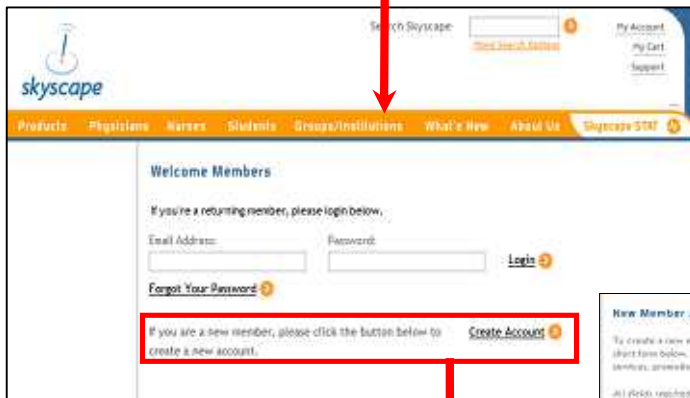


この時点で、Skyscape のユーザーアカウントをお持ちでない方は Skyscape へアクセスし、ユーザー登録をする必要があります。

”Create Account”から、新規のアカウントを作成して下さい。Skyscape の登録は任意の Eメール/パスワードで構いません。

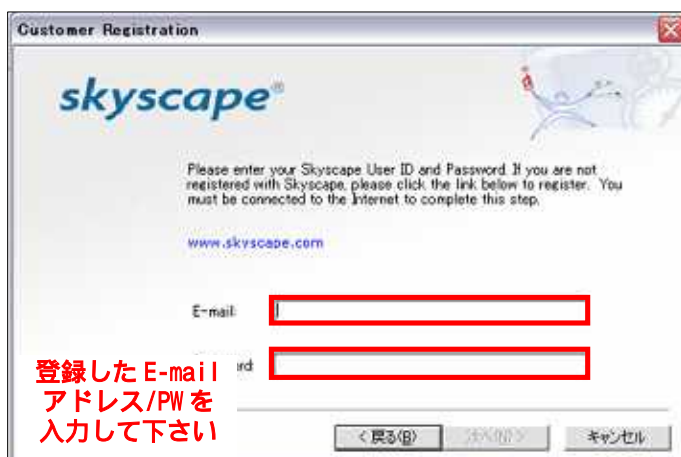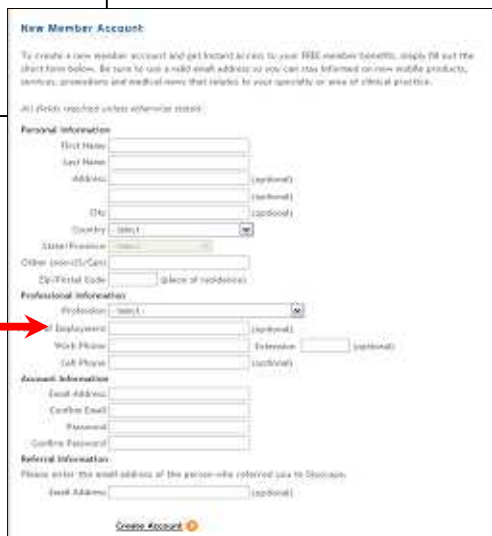


作成終了後は、インストール画面に登録した E-mail と PW を入力し、「次へ」をクリック。

#### 【4】シリアルナンバー登録

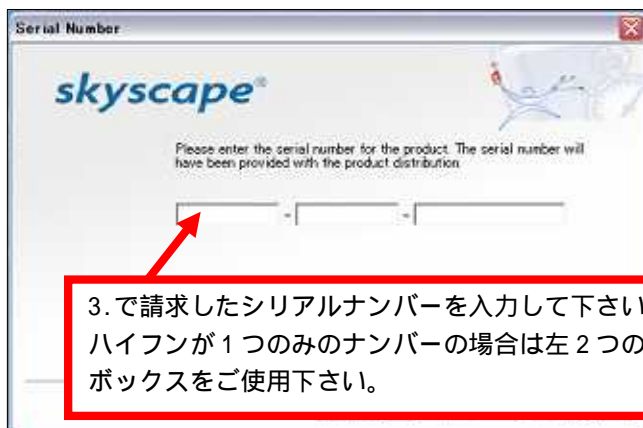

シリアルナンバー入力画面に移行します。  
事前に取得したシリアルナンバーを入力し、[次へ]をクリックして下さい。

最後に、[完了]をクリックしてください。  
PDA とパソコンが同期を始め、モバイル端末への DynaMed のインストールが開始されます。

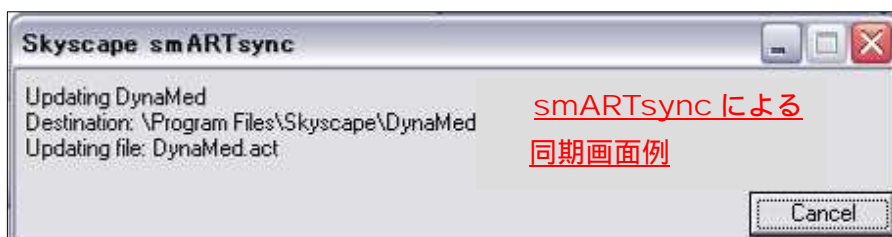

かなり時間がかかる場合がございますが、パソコンと PDA の接続を解除せずお待ち下さい



オプション機能がある場合には「Next device that performs a HotSync operation」と表示されます。さらに「Next」をクリックすると、PDA とパソコンが同期します。

## 【 5 】 DynaMed モバイル版へのアクセス

インストール終了後、PDA 上の「アプリケーション」から DynaMed を展開することができます。パソコンと同期化する度に、情報は自動的に更新されます。




## 【 DynaMed 起動時に、Unlock Code を求められる場合 】

通常、Unlock Code はシリアルナンバーを入力した段階で自動的に反映されるものですが、そうでない場合、PDA 上で DynaMed を始めて起動させる際に、入力を求めてきます。


以下の手順で、Skyscape の HP から Unlock Code 確認して下さい。

1. Skyscape に登録した E-mail アドレスとパスワードを使い、SkyScape の、My Account にログインしてください。

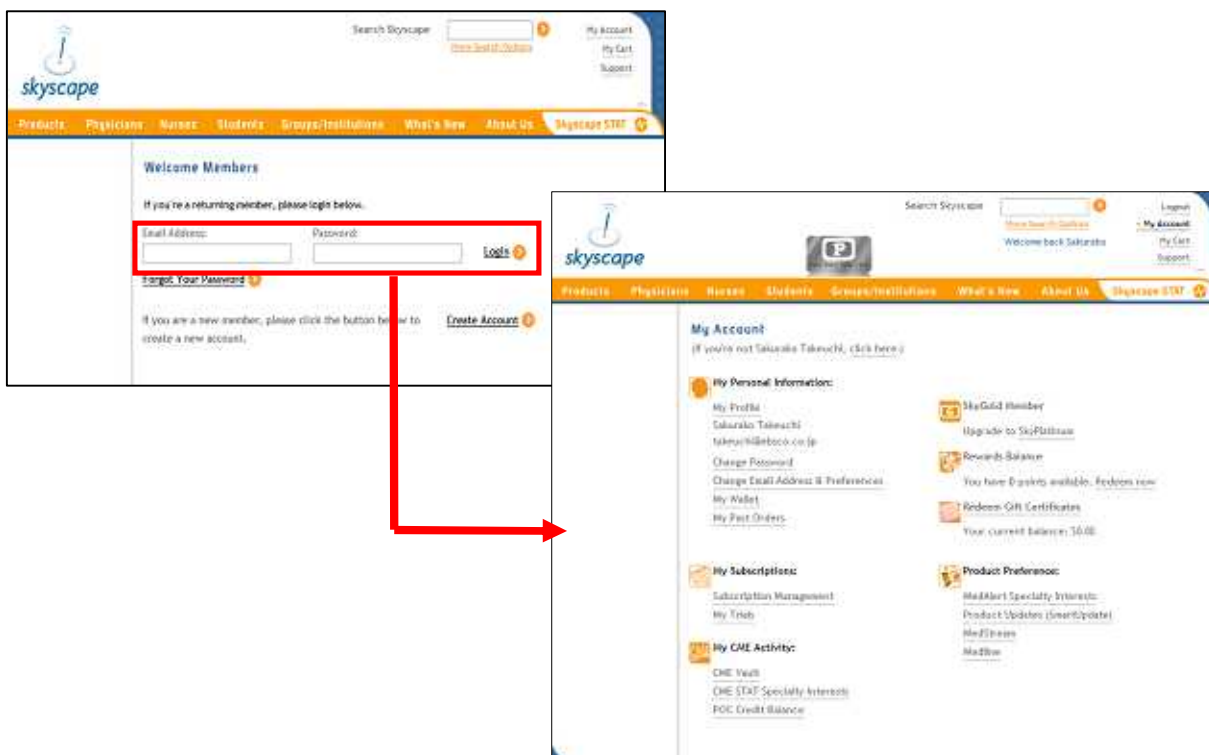



- My Subscription の項目にある “ Subscription Management ” をクリックして下さい。  
現在の登録状況が表示されます

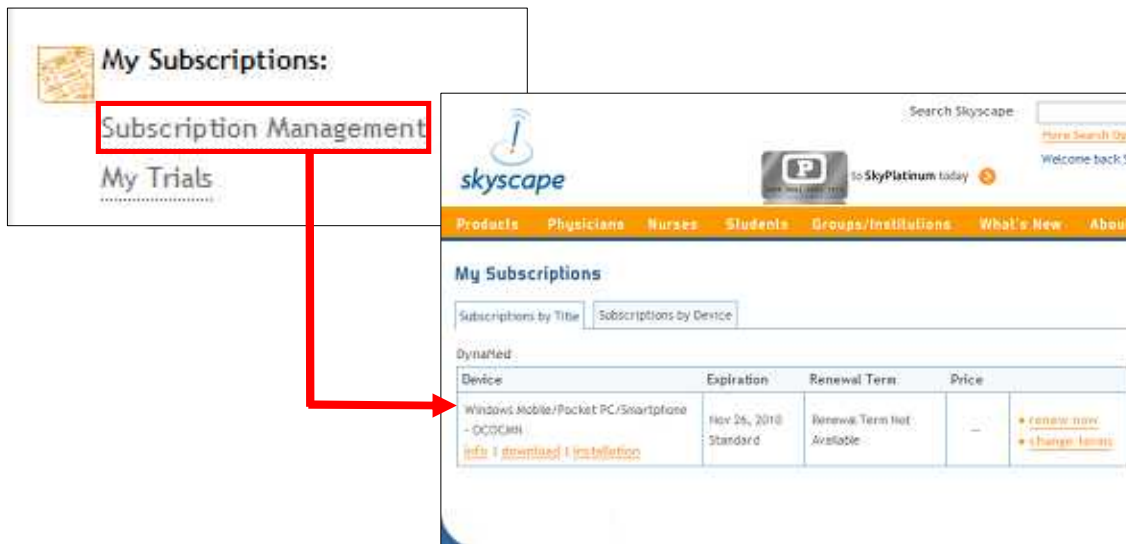

- DynaMed をインストールした機器の種類、および、Unlock Code 入力画面に表示されている端末コードが正しいか、ご確認下さい。


Device	Expiration	Renewal Term	Price
Windows Mobile/Pocket PC/Smartphone - OCOCMN <a href="#">info</a>   <a href="#">download</a>   <a href="#">installation</a>	Nov 26, 2010 Standard	Renewal Term Not Available	-- <a href="#">renew now</a> <a href="#">change terms</a>

DynaMed をインストールする機器

端末コード

- 確認したら、その下にある info のリンクをクリックして下さい。  
DynaMed の登録情報が表示されますので、その中の Unlock Code を PDA 側に入力し、  
ロックの解除を行ってください。

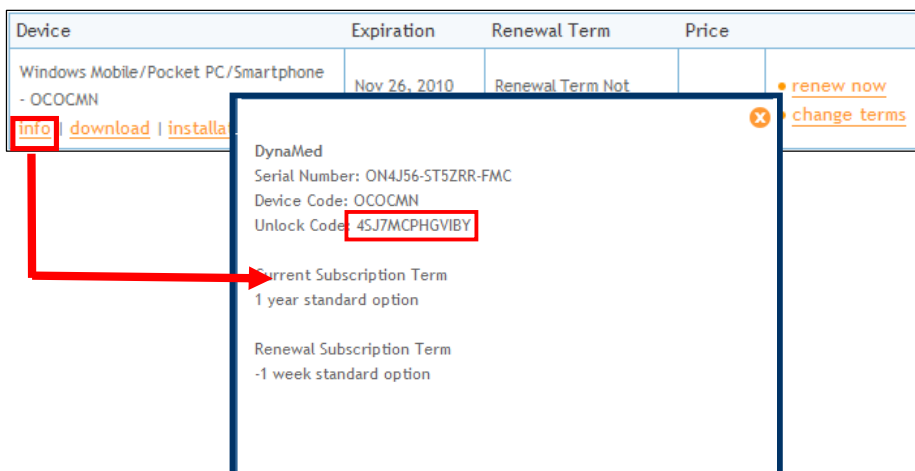

## 【 6 】 DynaMed モバイル版の更新


パソコンと同期化する度に、情報は自動的に更新されます。




## 5. DynaMedの更新ファイルを手動でダウンロードする(PDA版)

Skyscape は、パソコンの起動時に自動で更新ファイルを検索するよう設定されていますが、この章では、手動で更新を確認、ダウンロードする手順をご案内します。

- 【 1 】 My Skyscape を起動後、画面右端の  タブをクリックし、カスタム画面へ移動してください。

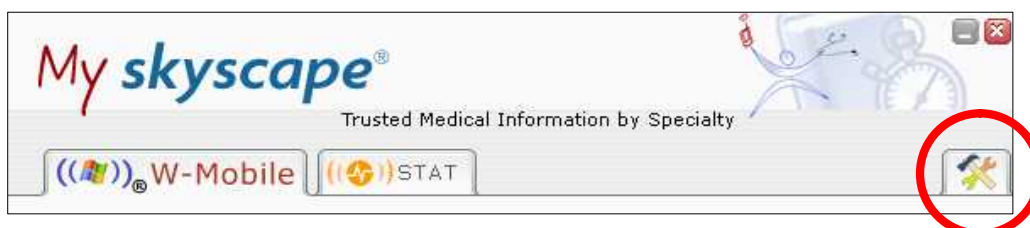

- 【 2 】 “Check for Updates”を選択してください。  
Skyscape が自動的に最新のアップデートファイルを検索します。

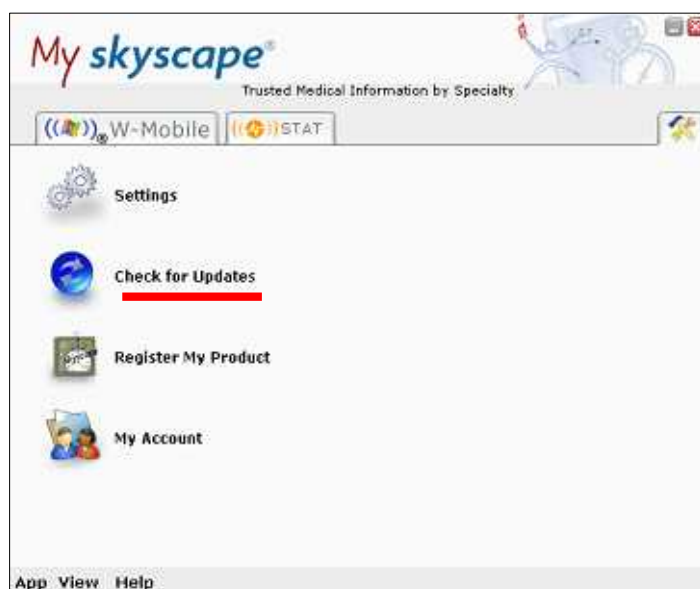

アップデートがある場合は、下の通り表示されますので、確認の上[next]をクリックして下さい。



初めて PC と PDA を同期させた場合  
パソコン側で、Skyscape のセットアップを求められることがあります。その場合は、  
下記の手順で登録をして下さい。



登録するデバイスの名称（任意）  
を入力し、[next]をクリックして  
下さい。



Skyscape に登録した User ID と Password を入力し、[done] をクリックして下さい。



登録が完了します。  
[finish] をクリックし、画面を閉じてください。

【3】 場合によっては、次ページのような確認画面が表示されることがあります。その際は、Accept Skyscape End User License Agreement (利用規約に同意する) にチェックをつけ、[next] をクリックして下さい。更新ファイルのダウンロードが始まります。



自動更新を有効にしている場合、PC の起動と同時に更新ファイルの検索を行います。更新を確認し、【2】からの手順を踏んでください。


ダウンロード終了後、PC にお手持ちの PDA を接続すると、同期が始まります。  
(再起動が必要な場合があります。各 PDA のインストール手順に従ってください)

ご注意ください

確認画面で表示されるファイルサイズが「1」の場合、ダウンロードを行うと、DynaMed が正常に動作しない恐れがあります。サイズ「1」のファイルが表示された場合は、Cancel をクリックして、ダウンロード作業を中止してください。





## 6. DynaMedをPDAで使う

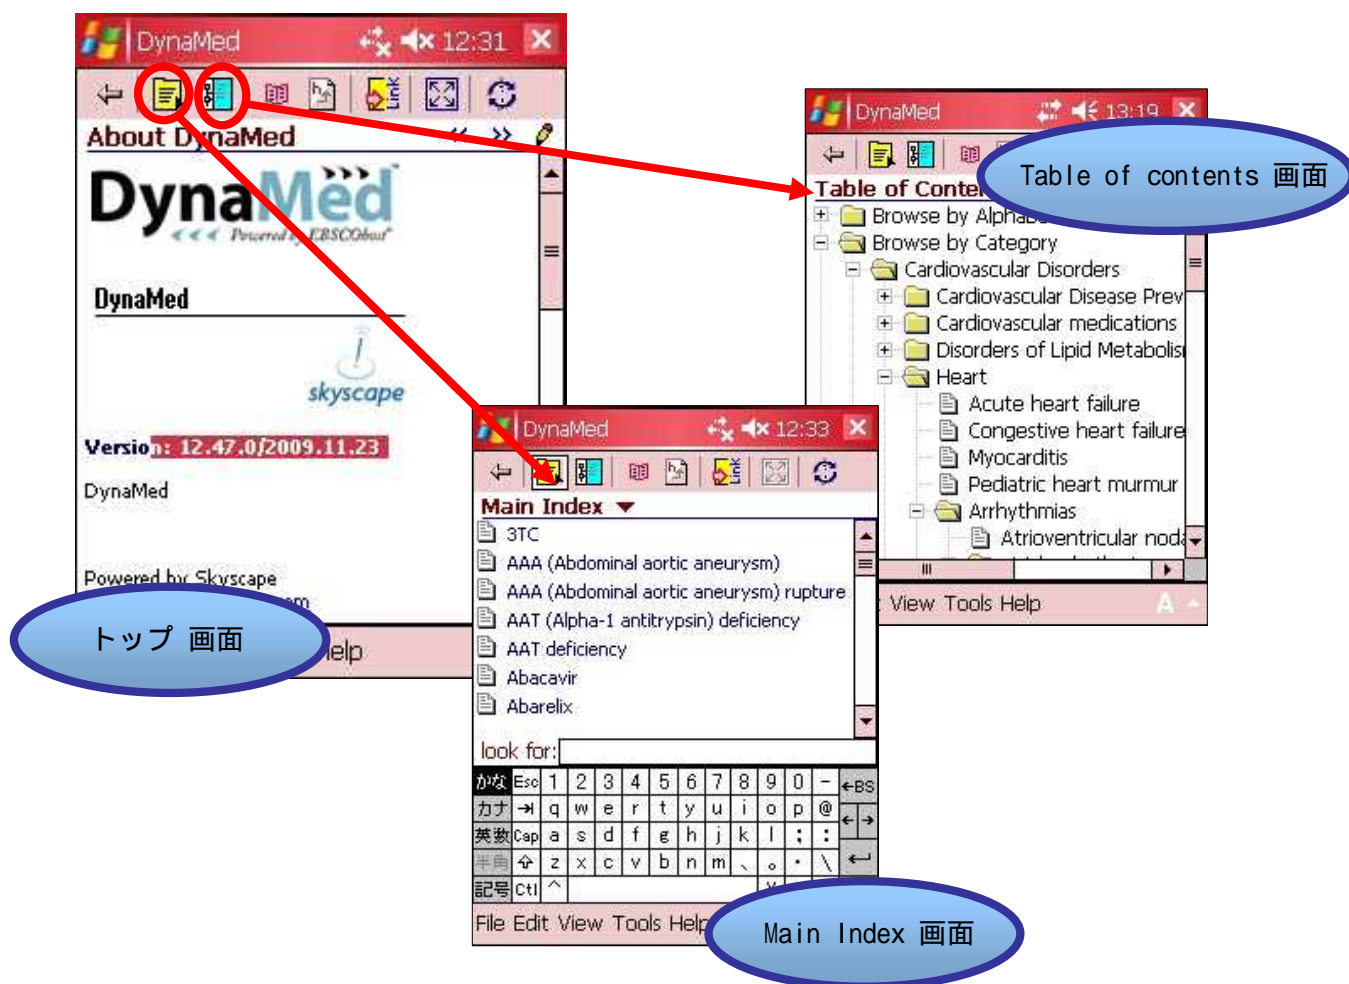



この画面は、Windows Mobile 端末のものになります。


### 【トップ画面で……】


- 1)  アイコンをタップすると、メインの検索画面へ移ります。  
look for; に検索したい病症名を入力すると、関連性の高い症例名が抽出されます。

また、各トピック画面で  アイコンをタップすると、そのトピックをブックマークすることが出来ます。

- 2)  アイコンをタップすると、Table of Contents による検索画面へ移ります。  
検索したいカテゴリーの名称をクリックすると、サブカテゴリーが表示されます。  
更にサブカテゴリーを展開させていくことで、目的のトピックを検索できます。

ここでも、各トピック画面で  アイコンをタップすると、そのトピックをブックマークすることが出来ます。

- 3)  アイコンをタップすると、今まで検索したトピックの履歴が表示されます。  
各トピック名をタップすることで、見たいトピック画面へジャンプします。


- 4)  アイコンをタップすると、現在インストールされている DynaMed for PDA のバージョンを確認することができます。[Check for Update]をタップすると、PC と同期し、最新版のダウンロードを開始します。




### 【各トピック画面で...】

各トピック画面は、PC 画面でご覧頂くものと同様の構成となっております。

画面右脇のインデックス（赤枠部分）をタップすることで、それぞれの項目へジャンプすることができます。

また、トピック画面で  アイコンをタップすると、MedAlert、MedStream に収録されている関連トピックへジャンプすることが出来ます。

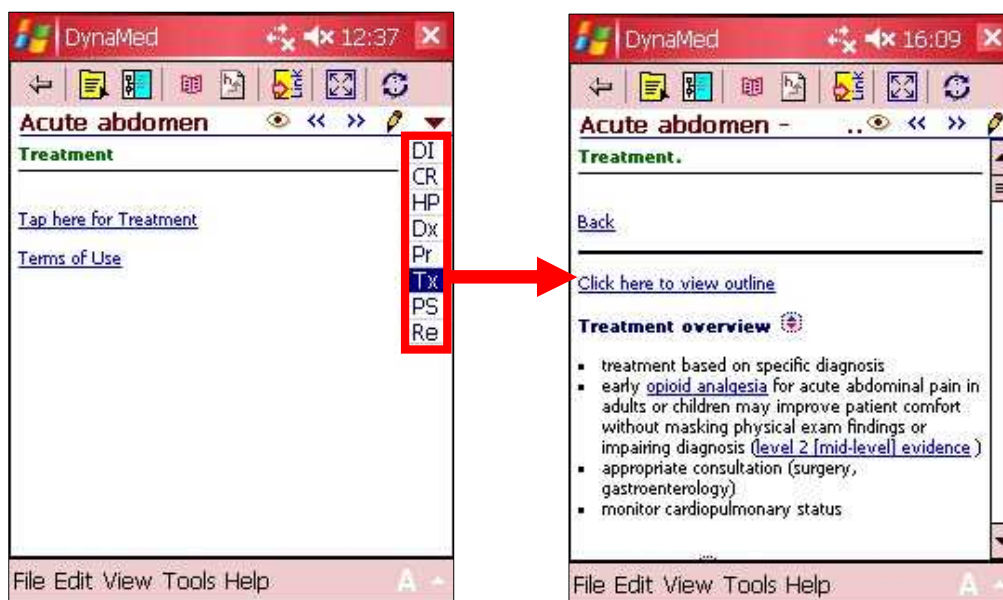

各インデックスが示す項目は、次の通りです。

- DI - Description: 疾病についての概要 (ICD-9 コード: 国際疾病分類を含む)
- CR - Causes and Risk Factors: 疾病の原因、リスクファクター解説
- HP - History and Physical: 病歴・主訴、身体所見などの解説
- Dx - Diagnosis: 診断、または診断法についての解説
- Pr - Prognosis: 予後についての解説
- Tx - Treatment: 治療についての解説
- PS - Prevention and Screening: 予防・スクリーニングについての解説
- Re - References: リファレンス (レビュー・ガイドラインを含む)

## 9. お問い合わせ先

EBSCO Publishing Japan (エブスコ) 医療系データベース部門

〒166-0002

東京都杉並区高円寺北 2-6-2

高円寺センタービル 8F

TEL: 03-5327-5321 FAX: 03-5327-5323

E-mail: [medical@ebSCO.co.jp](mailto:medical@ebSCO.co.jp)

DynaMed 日本語サポートページ(<http://www.ebSCO.co.jp/medical/dynamed>)の【問い合わせフォーム】もご利用いただけます。